




ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-381/13.03.2012 г.

**ДО УЧАСТНИЦИ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С  
ПРЕДМЕТ ”ДОСТАВКА,  
ВЪВЕЖДАНЕ В  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ,  
ГАРАНЦИОННО И  
СЛЕДГАРАНЦИОННО  
ОБСЛУЖВАНЕ НА  
ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНА  
АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА  
„СБАЛО” ЕАД – ГР. СОФИЯ И  
МБАЛ „СВ. МАРИНА” – ГР.  
ВАРНА”**

**Отговор на поставени въпрос относно:** *Обществена поръчка с предмет "Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛО” ЕАД – гр. София и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна” по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на „СБАЛО”” и проект „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна”, открита с Решение № РД-17-110/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0021*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следния въпрос:

**Въпрос:**

В Обособена позиция №3 „Доставка на магнитно-резонансен томограф за нуждите на СБАЛО – ЕАД” и по-конкретно в точка 7.4 е описано изискването „Изследвания на “движещи се пациенти” (“MR става като спирален КТ”), вкл. ангио изследвания на цяло тяло и/или крайници”.

Начинът, по който е описано това изискване директно повтаря рекламните послания на един конкретен производител и описва функцията Syngo TIM CT на *Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”*

фирмата Сименс, както може да се види от линка по-долу, чийто подход е да придобива трансверзални ангиографски образи при целетелесно сканиране, докато масата се движи.

Другите производители използват различен подход при целетелесно МР сканиране, който позволява изследване във всички възможни срезове (коронален, сагитален, трансверзален и кос)

<http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/PSGenericDisplay?storeId=10Q01&langd=-1&catalogId=-1&paaid=79806>


Описанието може да се счита за търговска марка, поради което, очакваме да предложите изискването за ЗОП и да приемете „еквивалентни“ технически решения, отговарящи на изискването на техническата спецификация или да прекратите офериранието на тази позиция.

**Отговор:**

Обособена позиция №3 „Доставка на магнитнорезонансен томограф за нуждите на СБАЛЮ – ЕАД” и по-точно в точка 7.4 е описано изискването „Изследвания на “движещи се пациенти” (“MR става като спирален КТ”), вкл. ангио изследвания на цяло тяло и/или крайници”.

Зададеното в спецификацията изискване описва най-добрата и ефективна техника за скрининг на определени зони и/или на цялото тяло за метастази. Конкретни търговски марки като Tim CT на Сименс не са посочени в спецификацията.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, за еквивалентни технически решения по тази точка ще се приемат, ако те предлагат ефективна техника за скрининг на определени зони на цялото тяло за метастази и при които по време на изследване на пациента не се налага неговото репозициониране. Това изискване е важно за „СБАЛЮ“ – ЕАД, защото уредбата ще се ползва за нуждите, както на Клиника по лъчелечение така и на Отделението по образна диагностика, за изследване и стадиране на онкологично болни.

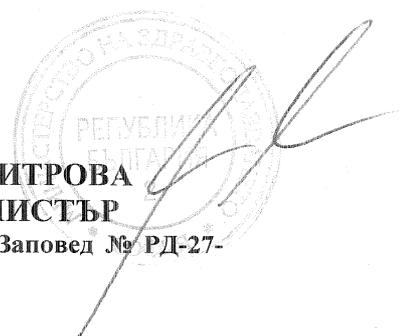  
**ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА**  
**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**  
/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./